

Số: 255/TB-TTYT

Quảng Hà, ngày 08 tháng 8 năm 2025

V/v thông báo nhu cầu tiếp nhận báo giá
thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Hải Hà

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Hải Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán kinh phí mua sắm thiết bị năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc sở Y tế, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, địa chỉ: Phó Trần Quốc Toàn - xã Quảng Hà - tỉnh Quảng Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Ngô Hà Sơn – Khoa Dược - TTBVTYT, SĐT: 0919193566
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Bản cứng (Bắt buộc): Tại khoa Dược - TTBVTYT, Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, địa chỉ: Phó Trần Quốc Toàn - xã Quảng Hà - tỉnh Quảng Ninh.
 - Bản mềm qua email: banmuasambvhh@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h 00 ngày 08 tháng 8 năm 2025 đến trước 14h 00 phút ngày 18 tháng 8 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát	Mô tả cụ thể tại phụ lục 02 Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế	01	Máy
Tổng: 01 danh mục				

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, địa chỉ: Phó Trần Quốc Toàn - xã Quảng Hà - tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến trước ngày 15 tháng 12 năm 2025.

4. Các thông tin khác:

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Lưu ý:


1. Trung tâm xem xét không tổng hợp đối với các báo giá trong các trường hợp sau:

- Không có báo giá bản cứng được ký bởi người có thẩm quyền;
- Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật;
- Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc không được ký bởi người không có thẩm quyền;
- Không đảm bảo thời gian giao hàng trước 15/12/2025.

Trung tâm Y tế huyện Hải Hà trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DS-TT&GDSK (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, Dược –TTB-VTTYT

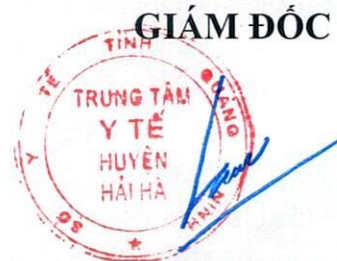

Nguyễn Thành Lam



PHỤ LỤC 01

Các yêu cầu chung về lập báo giá

(Kèm theo Thông báo số 255/TB-TTYT ngày 08 tháng 8 năm 2025
của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà)

STT	Thông tin	Chỉ tiêu	Đánh giá đáp ứng kỹ thuật của Báo giá
1	Công ty phải lập bảng đáp ứng tính năng chi tiết của hàng hóa do Công ty chào so với yêu cầu của Trung tâm như Mẫu tại Mẫu số 01 .	Có bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu	Đáp ứng
		Không có bảng đáp ứng hoặc bảng đáp ứng không có đầy đủ thông tin	Không đáp ứng

- Trung tâm đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dự trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật - **do công ty tự kê khai** - tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Trung tâm sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh.

- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong **Phụ lục 01** là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Trung tâm xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp hàng hóa công ty chào không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu. Trung tâm đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Trung tâm sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của công ty. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa, Trung tâm sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường những vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

- Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả thầu **gần nhất** trong vòng 90 ngày (nếu có) của (các) trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Trung tâm.

- Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.

- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện, dịch vụ kỹ thuật cần thiết để hoàn thành lắp đặt dựa vào sử dụng nhưng trong yêu cầu kỹ thuật chưa có, công ty có thể chào thêm ở phần tùy chọn, số lượng cụ thể.

- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện (tiêu hao hoặc định kỳ thay thế); gói dịch vụ kỹ thuật để duy trì hoạt động thường xuyên trong thời gian khấu hao máy theo quy định. Công ty chào Bệnh viện tham khảo.

Mẫu số 01. Bảng đáp ứng kỹ thuật
(Kèm theo Thông báo số 255/TB-TTYT ngày 08 tháng 8 năm 2025
của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà)

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

Yêu cầu mời chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 02)	Thông số kỹ thuật chào giá	
.....	Đáp ứng/ Không đáp ứng	- Nếu đáp ứng: Nêu chính xác thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. - Nếu không đáp ứng: Nêu rõ thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa trong kèm theo thuyết minh/lý giải. - Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể. Thể hiện chất lượng tốt hơn thì liệt kê kèm theo (các) tài liệu chứng minh.



Mẫu số 02
BẢO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế ()

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



PHỤ LỤC 02

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế
(Kèm theo Thông báo số: 255/TB-TTYT ngày 08 tháng 8 năm 2025
của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà)

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU Danh mục hàng hóa, yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật
1	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
I	YÊU CẦU CHUNG
	Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau, máy mới 100%
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA
	Máy chính: Xuất xứ thuộc các nước G7 (Bao gồm: Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần; Bàn chụp bệnh nhân; Giá chụp phổi; Cột bóng; Bóng phát tia Xray; Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số) đồng bộ, có cùng xuất xứ.
	Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm môi trường tối đa: $\geq 75\%$
	Nguồn điện sử dụng: Ba pha, 380V, 50Hz; tương thích với hệ thống điện đang sử dụng tại Trung tâm.
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH (Tối thiểu)
	Tủ điều khiển phát tia cao tần và bảng điều khiển: 01 bộ
	Bàn chụp bệnh nhân: 01 chiếc
	Giá chụp phổi bao gồm Bucky: 01 chiếc
	Cột bóng : 01 chiếc
	Bóng phát tia Xray: 01 chiếc
	Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 chiếc
	Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số: 02 chiếc
	Trạm điều khiển và thu ảnh số hóa: 01 bộ
	Bộ lưu điện cho trạm điều khiển: 01 chiếc
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt), tài liệu bảo dưỡng, sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual, PassWord truy cập...): 01 bộ
III	YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU
	1. Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần
	Công suất ≥ 50 kW
	Dải điện áp: Từ ≤ 40 kV đến ≥ 125 kV
	Dải mA: Từ ≤ 25 mA đến ≥ 600 mA, có nhiều bước điều chỉnh
	Dải mAs: Từ ≤ 1 mAs đến ≥ 600 mAs, có nhiều bước điều chỉnh
	Dải thời gian chụp: Từ $\leq 0,1$ giây đến ≥ 6 giây
	Điều khiển chụp: điều khiển chụp bằng tay
	Nguồn điện 3 pha
	2. Bàn chụp bệnh nhân mặt bàn dịch chuyển 4 hướng

Mặt bàn: Mặt dịch chuyển 4 hướng
Kích thước mặt bàn: $\geq (800 \times 2.200)$ mm
Di chuyển khối Bucky: ≥ 280 mm
Khoảng cách giữa mặt bàn và tấm cảm biến: ≤ 80 mm
Tải trọng tối đa: ≥ 250 kg
Hệ thống khoá: Khoá điện từ, với điều khiển mở khoá bằng bàn đạp chân
3. Giá chụp phổi
Kiểu: Gắn sàn tường
Kích thước khung đỡ phù hợp với tấm cảm biến
Dịch chuyển lên xuống: ≤ 350 mm đến ≥ 1.800 mm
Chiều sâu giá chụp phổi (tính từ tường tới bề mặt giá chụp phổi): ≤ 350 mm
Có tấm lọc tia thứ
Hệ thống khoá: Khoá điện từ
4. Cột bóng
Kiểu : gắn sàn, sàn tường hoặc trần
Di chuyển theo chiều dọc (cột mang bóng): ≥ 1.800 mm
Khoảng cách từ tâm tiêu điểm đến sàn : ≤ 500 mm đến ≥ 1.800 mm
Quay bóng quanh giá đỡ bóng: Theo chiều kim đồng hồ ≥ 140 độ; ngược chiều kim đồng hồ ≥ 140 độ
Vị trí mặc định: 0°
Hệ thống khoá: Khoá điện từ
5. Bóng phát tia Xray
Kiểu bóng: Bóng anode quay, tốc độ quay đạt ≥ 2.700 vòng/phút tại 50 Hz
Điện áp khi chụp tối đa: ≥ 125 kV
Khả năng trữ nhiệt tối đa của Anode: ≥ 300 kHU
Tiêu điểm bóng: tiêu điểm kép + Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.6 mm + Tiêu điểm lớn: ≥ 1.2 mm
Góc hứng tia: ≥ 12 độ
Có mạch bảo vệ quá dòng
6. Bộ chuẩn trực chùm tia
Xoay bằng tay hoặc tự động
Kiểu: đèn LED hoặc tương đương
Căn chỉnh laser
Rò rỉ bức xạ tối đa: ≥ 150 kVp, ≥ 4 mA
Hẹn giờ tích hợp
Điều chỉnh đóng mở: Bằng tay
Lọc tia: ≥ 1 mm nhôm hoặc tương đương
7. Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số
Cảm biến chuyển đổi tia X thành hình ảnh kỹ thuật số
Loại tấm: Tấm cảm biến phẳng

	Điểm ảnh: $\geq 3.000 \times 3.000$ pixel
	Kích thước điểm ảnh: $\leq 140\mu\text{m}$
	Dữ liệu hình ảnh: ≥ 16 bit
	Truyền dữ liệu: Có dây hoặc Không dây
	8. Trạm điều khiển và thu ảnh số hóa
	- Màn hình: ≥ 24 inch
	- Máy tính: + Bộ xử lý Intel core i7 gen 14 hoặc tốt hơn + Ram $\geq 16\text{GB}$ + Ổ cứng SSD $\geq 1\text{T}$ + VGA rời $\geq 4\text{gb}$ + Windows 11 bản quyền
	Phần mềm bao gồm:
	Phần mềm đồng bộ cùng hãng sản xuất (hãng sở hữu) máy X quang
	Hỗ trợ DICOM và hình ảnh truyền đến máy chủ PACS
	Hỗ trợ 2 tấm thu nhận ảnh song song
	Có chức năng lưu ảnh ra ổ cứng ngoài
	Có chức năng xử lý giảm nhiễu ảnh
	Có chức năng đo đặc khoảng cách, đo góc, Zoom to/nhỏ, Cắt ảnh elip ...
	9. Bộ lưu điện: UPS online 2kVA
IV	YÊU CẦU KHÁC
	Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm Y tế Hải Hà trước 10/12/2025.
	Đồng bộ với thiết bị đang dùng tại đơn vị
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Ghi rõ thời gian bảo hành bóng phát tia Xray
	Có chế độ miễn phí nhân công sau bảo hành
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 48 giờ
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm
	Dùng chung với hệ thống đang dùng tại đơn vị